


デュー製品の高性能を支える

## 校正 & 調整校正




機器を最良の状態でするのに、校正 & 調整校正は欠かせません  
東洋テックはデュー製品の、校正のみならず 調整校正も可能です

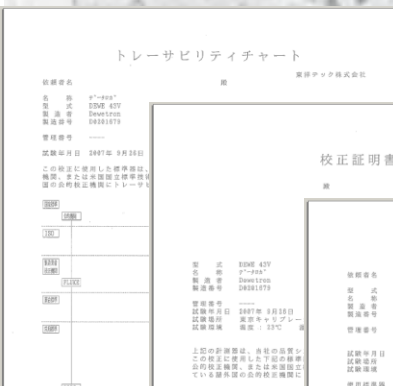


試験成績書

項目	単位	標準値	測定値	許容範囲	結果
DC 0V	V	0.0000	-0.00100	±0.0010	OK
DC 10V	V	10.0000	9.99900	±0.0010	OK
DC 20V	V	20.0000	19.99800	±0.0010	OK
DC 30V	V	30.0000	29.99600	±0.0010	OK
DC 40V	V	40.0000	39.99400	±0.0010	OK
DC 50V	V	50.0000	49.99200	±0.0010	OK
DC 60V	V	60.0000	59.99000	±0.0010	OK
DC 70V	V	70.0000	69.98800	±0.0010	OK
DC 80V	V	80.0000	79.98600	±0.0010	OK
DC 90V	V	90.0000	89.98400	±0.0010	OK
DC 100V	V	100.0000	99.98200	±0.0010	OK

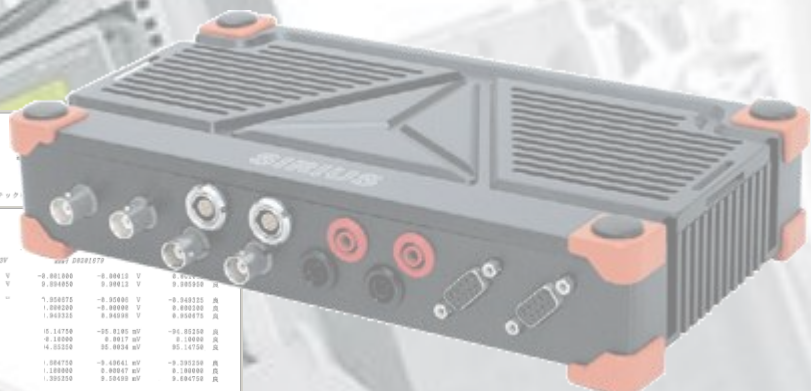

### 調整校正の必要性

入力部のアンプは、経年変化により±バランスがくずれ、出力部にオフセット電圧が生じ、波形を歪ませることがあります。調整校正がこの不具合を防ぎます。

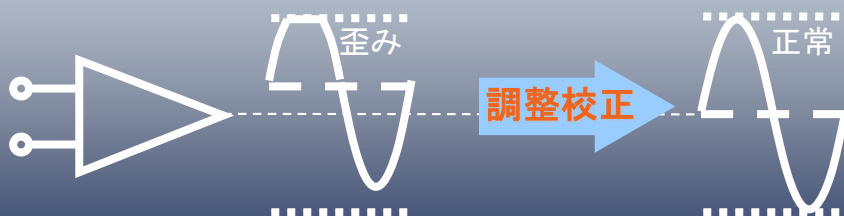

東洋テックはデュー製品の調整校正も可能です

# ■ 校正価格 (校正証明書、試験成績書、トレーサビリティチャート付き 2015年2月現在)

品名	入力	型式	校正 (型式-CAL-TO)	前後データ付き 調整校正 (型式-RECAL-TO)	
DEWE-43シリーズ	8ch.ひずみ	DEWE-43A	¥50,500	¥80,200	
	8ch.ひずみ	DEWE-43N	¥50,500	¥80,200	
品名	入力	型式	校正 (型式-CAL-TO)	前後データ付き 調整校正 (型式-RECAL-TO)	
DS-NETシリーズ	8ch.熱電対	DS-NET-TH8	¥37,000	¥60,000	
	8ch.熱電対	DS-NET-TH8-C	¥37,000	¥60,000	
	4ch.熱電対	DS-NET-TH4	¥37,000	¥60,000	
	4ch.ひずみ	DS-NET-BR4	¥37,000	¥60,000	
	4ch.ひずみ	DS-NET-BR4-D	¥37,000	¥60,000	
	8ch.ひずみ	DS-NET-BR8-D	¥37,000	¥60,000	
	8ch.電圧	DS-NET-V8	¥37,000	¥60,000	
	8ch.電圧	DS-NET-V8-B	¥37,000	¥60,000	
	8ch.電圧	DS-NET-V8-200	¥37,000	¥60,000	
	4ch.電圧	DS-NET-V4	¥37,000	¥60,000	
	4ch.電圧	DS-NET-V4-B	¥37,000	¥60,000	
	4ch.電圧	DS-NET-V4-HV-B	¥37,000	¥60,000	
	2ch.IEPE	DS-NET-ACC2	¥37,000	¥60,000	
	2ch.ACひずみ	DS-NET-CFB2	¥37,000	¥60,000	
	品名	入力	型式	校正 (型式-CAL-TO)	前後データ付き 調整校正 (型式-RECAL-TO)
	SIRIUSi (アイソレーション)シリーズ	電圧/IEPE:8ch	SIRIUSi 8xACC	¥50,500	¥80,200
電圧/IEPE:8ch.カウンタ:2ch.		SIRIUSi 6xACC,2xACC+	¥50,500	¥80,200	
マルチ入力:8ch		SIRIUSi 8xMULTI	¥50,500	¥80,200	
ひずみ:8ch		SIRIUSi 8xSTGM	¥50,500	¥80,200	
ひずみ:8ch.カウンタ:8ch		SIRIUSi 8xSTGM+	¥50,500	¥80,200	
ひずみ:8ch		SIRIUSi 8xSTG	¥50,500	¥80,200	
ひずみ:8ch.カウンタ:8ch		SIRIUSi 8xSTG+	¥50,500	¥80,200	
ひずみ:8ch		SIRIUSi 8xSTGM,DB	¥50,500	¥80,200	
高電圧:8ch		SIRIUSi 8xHV	¥50,500	¥80,200	
チャージ:8ch		SIRIUSi 8xCHG	¥50,500	¥80,200	
チャージ:8ch.カウンタ:2ch.		SIRIUSi 6xCHG,2xCHG+	¥50,500	¥80,200	
電圧:8ch		SIRIUSi 8xLV	¥50,500	¥80,200	
高電圧:8ch.カウンタ:8ch	SIRIUSi 8xLV+	¥50,500	¥80,200		
品名	入力	型式	校正 (型式-CAL-TO)	前後データ付き 調整校正 (型式-RECAL-TO)	
SIRIUS-MINIシリーズ	電圧/IEPE:4ch.カウンタ:1ch	SIRIUSm 3xACC, 1xACC+	¥40,200	¥64,800	
	電圧/IEPE:4ch	SIRIUSm 4xACC	¥40,200	¥64,800	
品名	入力	型式	校正 (型式-CAL-TO)	前後データ付き 調整校正 (型式-RECAL-TO)	
SIRIUS HDシリーズ	ひずみ:16ch	SIRIUS-HD 16xSTGS	¥88,400	¥137,100	
	電圧:16ch	SIRIUS-HD 16xLV	¥88,400	¥137,100	
	ひずみ:16ch	SIRIUS-HD 16xSTGS	¥88,400	¥137,100	
	電圧:16ch	SIRIUS-HD 16xLV	¥88,400	¥137,100	
品名	入力	型式	校正 (型式-CAL-TO)	前後データ付き 調整校正 (型式-RECAL-TO)	
MSIコネクタ	熱電対タイプK	MSI-TH-K	¥7,500	-	
	熱電対タイプJ	MSI-TH-J	¥7,500	-	
	熱電対タイプT	MSI-TH-T	¥7,500	-	
	熱電対タイプC	MSI-TH-C	¥7,500	-	
	IEPE	MSI-ACC	¥7,500	-	
	電圧	MSI-V200	¥7,500	-	
	測温抵抗体	MSI-RTD	¥7,500	-	
	チャージ	MSI-CH-50	¥7,500	-	
品名	入力	型式	校正 (型式-CAL-TO)	前後データ付き 調整校正 (型式-RECAL-TO)	
CPAD	熱電対8ch	C-PAD-TH-x	¥40,000	¥64,500	




東洋テック株式会社

<http://www.toyotech.co.jp>

■ 本社、東京キャリブレーションセンター  
 〒101-0021 東京都千代田区外神田1-3-12 計測器ランドビル  
 Tel: 03-3251-8676(代) Fax: 03-3251-8258

■ **認定校正** 東洋テック キャリブレーション・ラボラトリーは、ISO/IEC17025 に基づく校正機関として認定されています  
**ISO/IEC 17025 認定校正**

- ・ 電磁気量: 直流電圧, 直流電流, 交流電圧, 交流電流, 直流抵抗
- ・ 幾何学量: マイクロメータ
- ・ 熱力学量: 抵抗温度計, 熱電対温度計, 温度校正装置

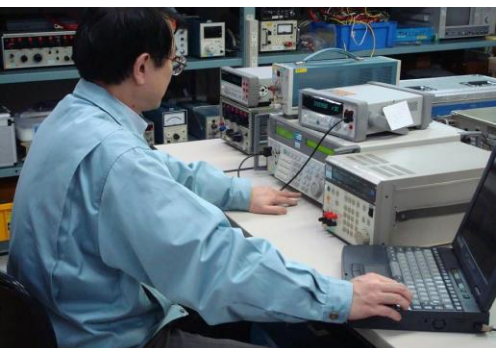

お問合せ先

お買い上げ販売会社